




Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06

OPIS:

Aktywuje i wzmacnia muskulaturę pasa biodrowego, poprawia funkcje układu sercowo-naczyniowego i oddechowego.

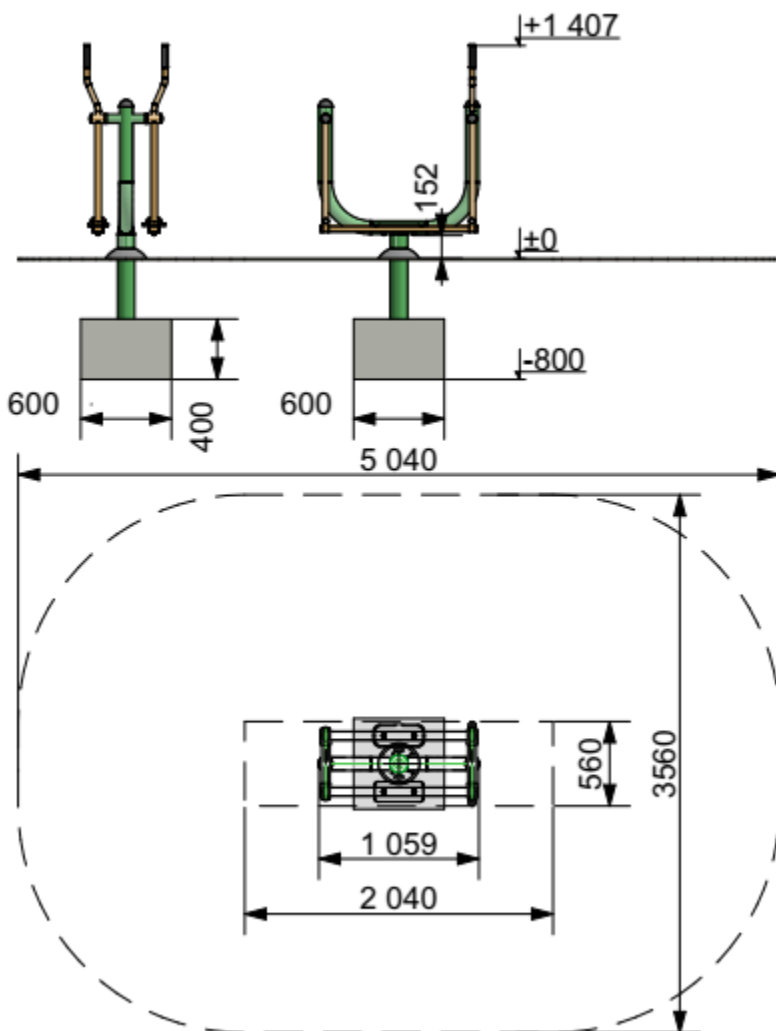

DANE TECHNICZNE:

- Wzrost użytkownika powyżej 140 cm
- Gabaryty urządzenia 56,0 x 105,9 (204,0) cm
- Strefa funkcjonowania 356,0 x 504,0 cm
- Wysokość maksymalna urządzenia ~ 138,0 cm
- Głębokość posadowienia -0,50 m
- Max. waga użytkownika 140 kg

MATERIAŁY:

- Elementy wykonane z stali cynkowanej, malowanej proszkowo.
- Rury konstrukcyjne o wymiarach $\varnothing 42,4 \times 2,3$, $\varnothing 114 \times 3$, $\varnothing 33,7 \times 2,7$, $\varnothing 60 \times 3,2$, $\varnothing 88,9 \times 3,2$
- Śruby osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego.
- Całość wykonana w sposób przyjazny dla ćwiczącego bez kantów i ostrych krawędzi.
- Urządzenie posiada tabliczkę z instrukcją obsługi.
- Stopki wykonane z HDPE lub blacha.
- Posadowienie stopy stalowe ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.

MONTAŻ:

- Wyroby związane z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją zestawu.
- Montażu dokonują wyspecjalizowane ekipy montażowe producenta.
- Metalowa kotwa prefabrykowana, stabilizowana poprzecznie drutem żebrowanym $\varnothing 12$ mm.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

- Urządzenie przeznaczone jest do montażu na przestrzeni ogólnodostępnej.
- Zestaw treningowy przeznaczony jest dla osób posiadających wzrost powyżej 140 cm
- Korzystanie z urządzenia w przypadku dzieci i młodzieży powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.
- Urządzenie powinno być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.
- Liczba osób mogących jednocześnie przebywać na urządzeniu nie powinna przekraczać 1.